

**ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC**

Số: ~~775~~ /BVĐHYD-CS3

V/v mời chào giá

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5. năm 2021

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM mời các Quý nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng cung cấp nổi trội dược liệu có giá nhiệt thấp báo giá theo phụ lục đính kèm.

Đề nghị Quý nhà cung cấp gửi file word/excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đính kèm đến email moichaogia@umc.edu.vn và gửi bản giấy có đóng dấu về Cơ sở 3, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM (địa chỉ 221B Hoàng Văn Thụ, Phường 08, Quận Phú Nhuận, TP HCM).

- Hồ sơ gửi kèm theo báo giá bao gồm các tài liệu sau:

+ Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có).

+ Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác).

- Thời gian nhận báo giá: đến hết ngày 12 / 5 /2021

- Điện thoại liên hệ: 0988335252 (Dương Nguyễn Ánh Ngọc – Cơ sở 3). ✓

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, CS3 (B19-010-3-dnangoc) (03).

K. GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Tấn
Phó Giám đốc

12



PHỤ LỤC. DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo Công văn mời chào giá số .77.5..../BVĐHYD-CS3)

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	NỒI TRỘN ĐƯỢC LIỆU CÓ GIA NHIỆT THẤP	Cơ sở sản xuất có ISO 9001, ISO 13485. Năng suất: 15-20 kg/mẻ tùy đường kính hoàn, tích hợp bộ gia nhiệt. Công suất tổng: 1HP – 380V – 3 pha. Thành phần: • Thùng chứa nguyên liệu hình cầu: Ø 600mm, Inox 304 dày 1,5mm. • Khung sườn bao che xung quanh, Inox 201. • Bộ chân đứng thao tác. • Bộ thổi gió nóng - điều chỉnh nhiệt tự động: Từ nhiệt độ phòng 20 °C đến 80 °C, 220 m³/h. • Tủ điện điều khiển gồm: Đồng hồ thời gian – relay – contactor.	Cái	01	



HÌNH VẼ MÔ TẢ NGUYÊN LÝ CẤU TẠO
NỒI TRỘN DƯỢC LIỆU CÓ GIA NHIỆT THẤP

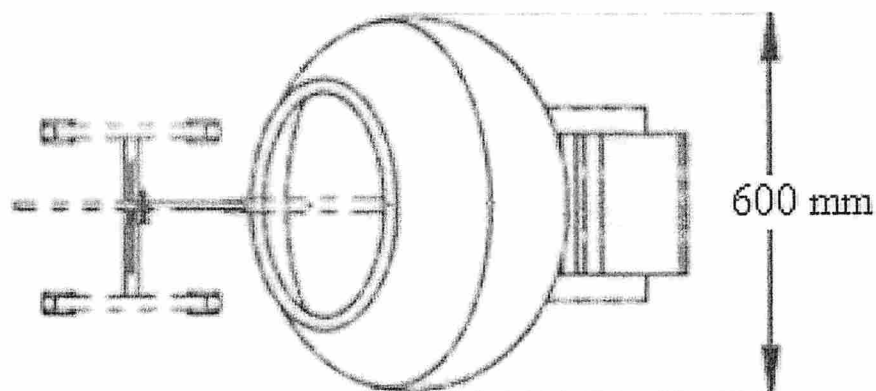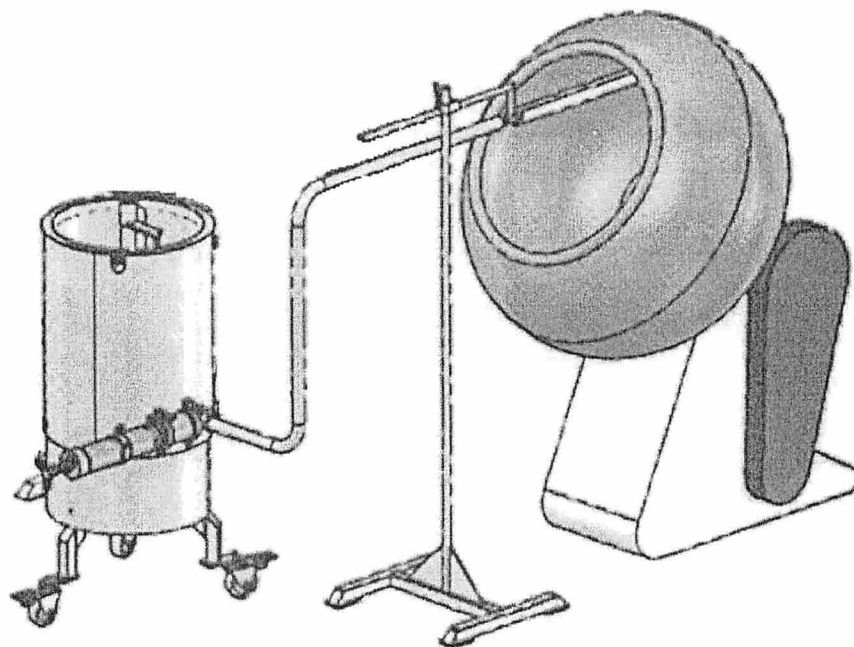

12